



成績証明書

平成 24年 01月 23日

会社名 株式会社ガイア

様

住所 136-0071
東京都江東区亀戸1-10-9

依頼品	炭酸カリウム、重炭酸カリウム、未知試料
依頼事項	赤外吸収スペクトル測定

平成 24年 01月 19日 付でご依頼のありました上記試験の成績は、次頁のとおりです。

平成 24年 01月 23日

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター理事長



- (注) ・成績証明書の記載内容は、利用者が持参した試験品に対する試験成績であって、商品(材料、部品、製品等)全体の性能・効能等を保証するものではありません。
・依頼品の品名、定格・仕様等は、依頼者の申請に基づき記載したものです。
・本成績証明書の内容を広告等その他に掲載しようとする場合は、あらかじめ地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの承認を受けてください。

依頼品

炭酸カリウム 重炭酸カリウム 未知試料



赤外分光光度計による測定

試験方法

試験装置 : JASCO FT/IR 4200 (日本分光製)




測定範囲 : 4000 cm^{-1} - 400 cm^{-1}

分解能 : 4 cm^{-1}

測定方法 : KBr法

積算回数 : 20回

試験結果

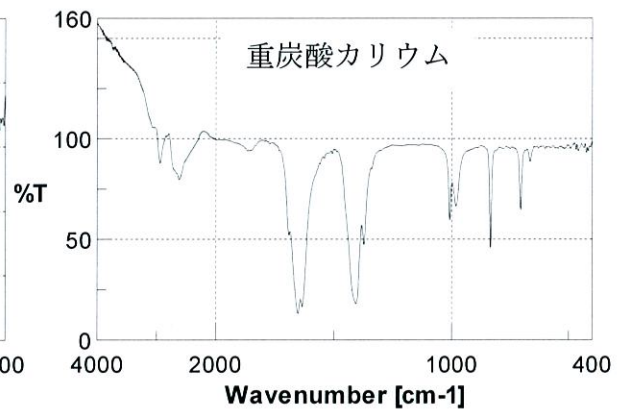

以上

* 依頼品の品名、定格等は依頼者の申請に基づいて記載した。

